


Test	Ergebnis	Referenzbereich	NIEDRIG	NORMAL	HOCH
LaserCyte Dx (3. Juni 2016 15:37)					
					20.05.16 13:27
RBC	5,69 x10 ¹² /L	5.50 - 8.50			4,39 x10 ¹² /L
HCT	38,6 %	37.0 - 55.0			30,8 %
HGB	12,7 g/dL	12.0 - 18.0			10,3 g/dL
MCV	67,9 fL	60.0 - 77.0			70,1 fL
MCH	22,4 pg	18.5 - 30.0			23,5 pg
MCHC	32,9 g/dL	30.0 - 37.5			33,5 g/dL
RDW	19,1 %	14.7 - 17.9			19,4 %
%RETIC	0,3 %				0,4 %
RETIC	15,1 K/μL	10.0 - 110.0			17,9 K/μL
WBC	29,52 x10 ⁹ /L	5.50 - 16.90			18,64 x10 ⁹ /L
%NEU	87,5 %				* 86,7 %
%LYM	3,6 %				4,5 %
%MONO	8,1 %				* 8,3 %
%EOS	0,7 %				0,5 %
%BASO	0,2 %				0,0 %
NEU	25,83 x10 ⁹ /L	2.00 - 12.00			* 16,16 x10 ⁹ /L
LYM	1,06 x10 ⁹ /L	0.50 - 4.90			0,84 x10 ⁹ /L
MONO	2,39 x10 ⁹ /L	0.30 - 2.00			* 1,54 x10 ⁹ /L
EOS	0,21 x10 ⁹ /L	0.10 - 1.49			0,10 x10 ⁹ /L
BASO	0,05 x10 ⁹ /L	0.00 - 0.10			0,01 x10 ⁹ /L
PLT	< 1 K/μL	175 - 500			< 1 K/μL
MPV	-- fL				-- fL
PDW	-- %				-- %
PCT	-- %				-- %

Wert außerhalb des Referenzbereiches (VRL)


WBC abnormale Verteilung (WD)
Wert außerhalb des Referenzbereiches (VRL)

RBC-Durchlauf

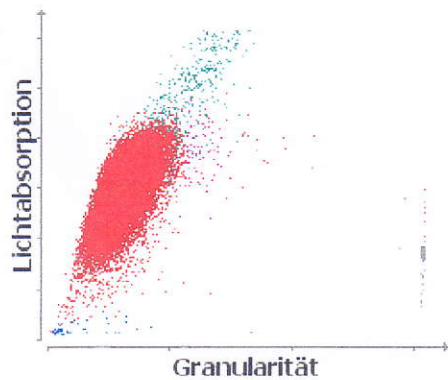

■ RBC ■ RETICS ■ PLT ■ RBC-Frag ■ Dubletten
■ QualiBeads

WBC-Durchlauf

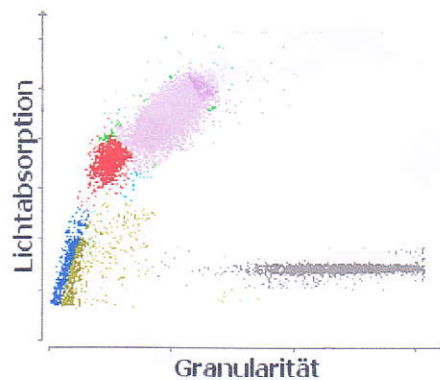

■ NEU ■ LYM ■ MONO ■ EOS ■ BASO
■ PLT AGG ■ WBC-Frag ■ uRBC ■ QualiBeads